

Wojewódzki Szpital Podkarpacki
im. Jana Pawła II w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA
Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497
NIP 684-21-20-222, Regon 000308620, KRS 00000 14669

EZ/215/44/2012

Krosno, dn. 17.05. 2012r.

*Do wszystkich uczestników postępowania
www.krosno.med.pl*

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą protez naczyniowych, klipsów laparoskopowych i elektrod nr postępowania EZ/215/44/2012.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr III pozycji 3 i 4 do odrębnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający dzieli powyższy pakiet w następujący sposób: Pakiet III – pozycja 1,3,4 Pakiet IIIa – pozycja 2
Pakiet IIIb – pozycja 5 Pakiet IIIc – pozycja 6.

Pytanie 2:

Prosimy o umożliwienie zaoferowania w pozycji 3 Pakietu nr III protez naczyniowych rozwidlonych o długości 45 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 dopuści elektrodę bierną dzieloną z pierścieniem ekwipotencjalnym powierzchnia kontaktowa 85 cm² powierzchnia pierścienia 23 cm² produkcji ERBE Elektromedizin GmbH?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Pakietu nr III pozycji 5 z barwnymi oznacznikami lub zezwoli w tym pakiecie na złożenie oferty w poszczególnych pozycjach?

Odpowiedź:

Zamawiający dzieli powyższy pakiet w następujący sposób: Pakiet III – pozycja 1,3,4 Pakiet IIIa – pozycja 2
Pakiet IIIb – pozycja 5 Pakiet IIIc – pozycja 6.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający zgodzi się wydłużyć termin dostawy do 3 dni roboczych, a w przypadku dostaw na cito do 48h?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający zgadza się aby słowo 'opóźnienia' zostało zastąpione słowem 'zwłoki'?

Odpowiedź:


Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian.

Pytanie 7:

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian.

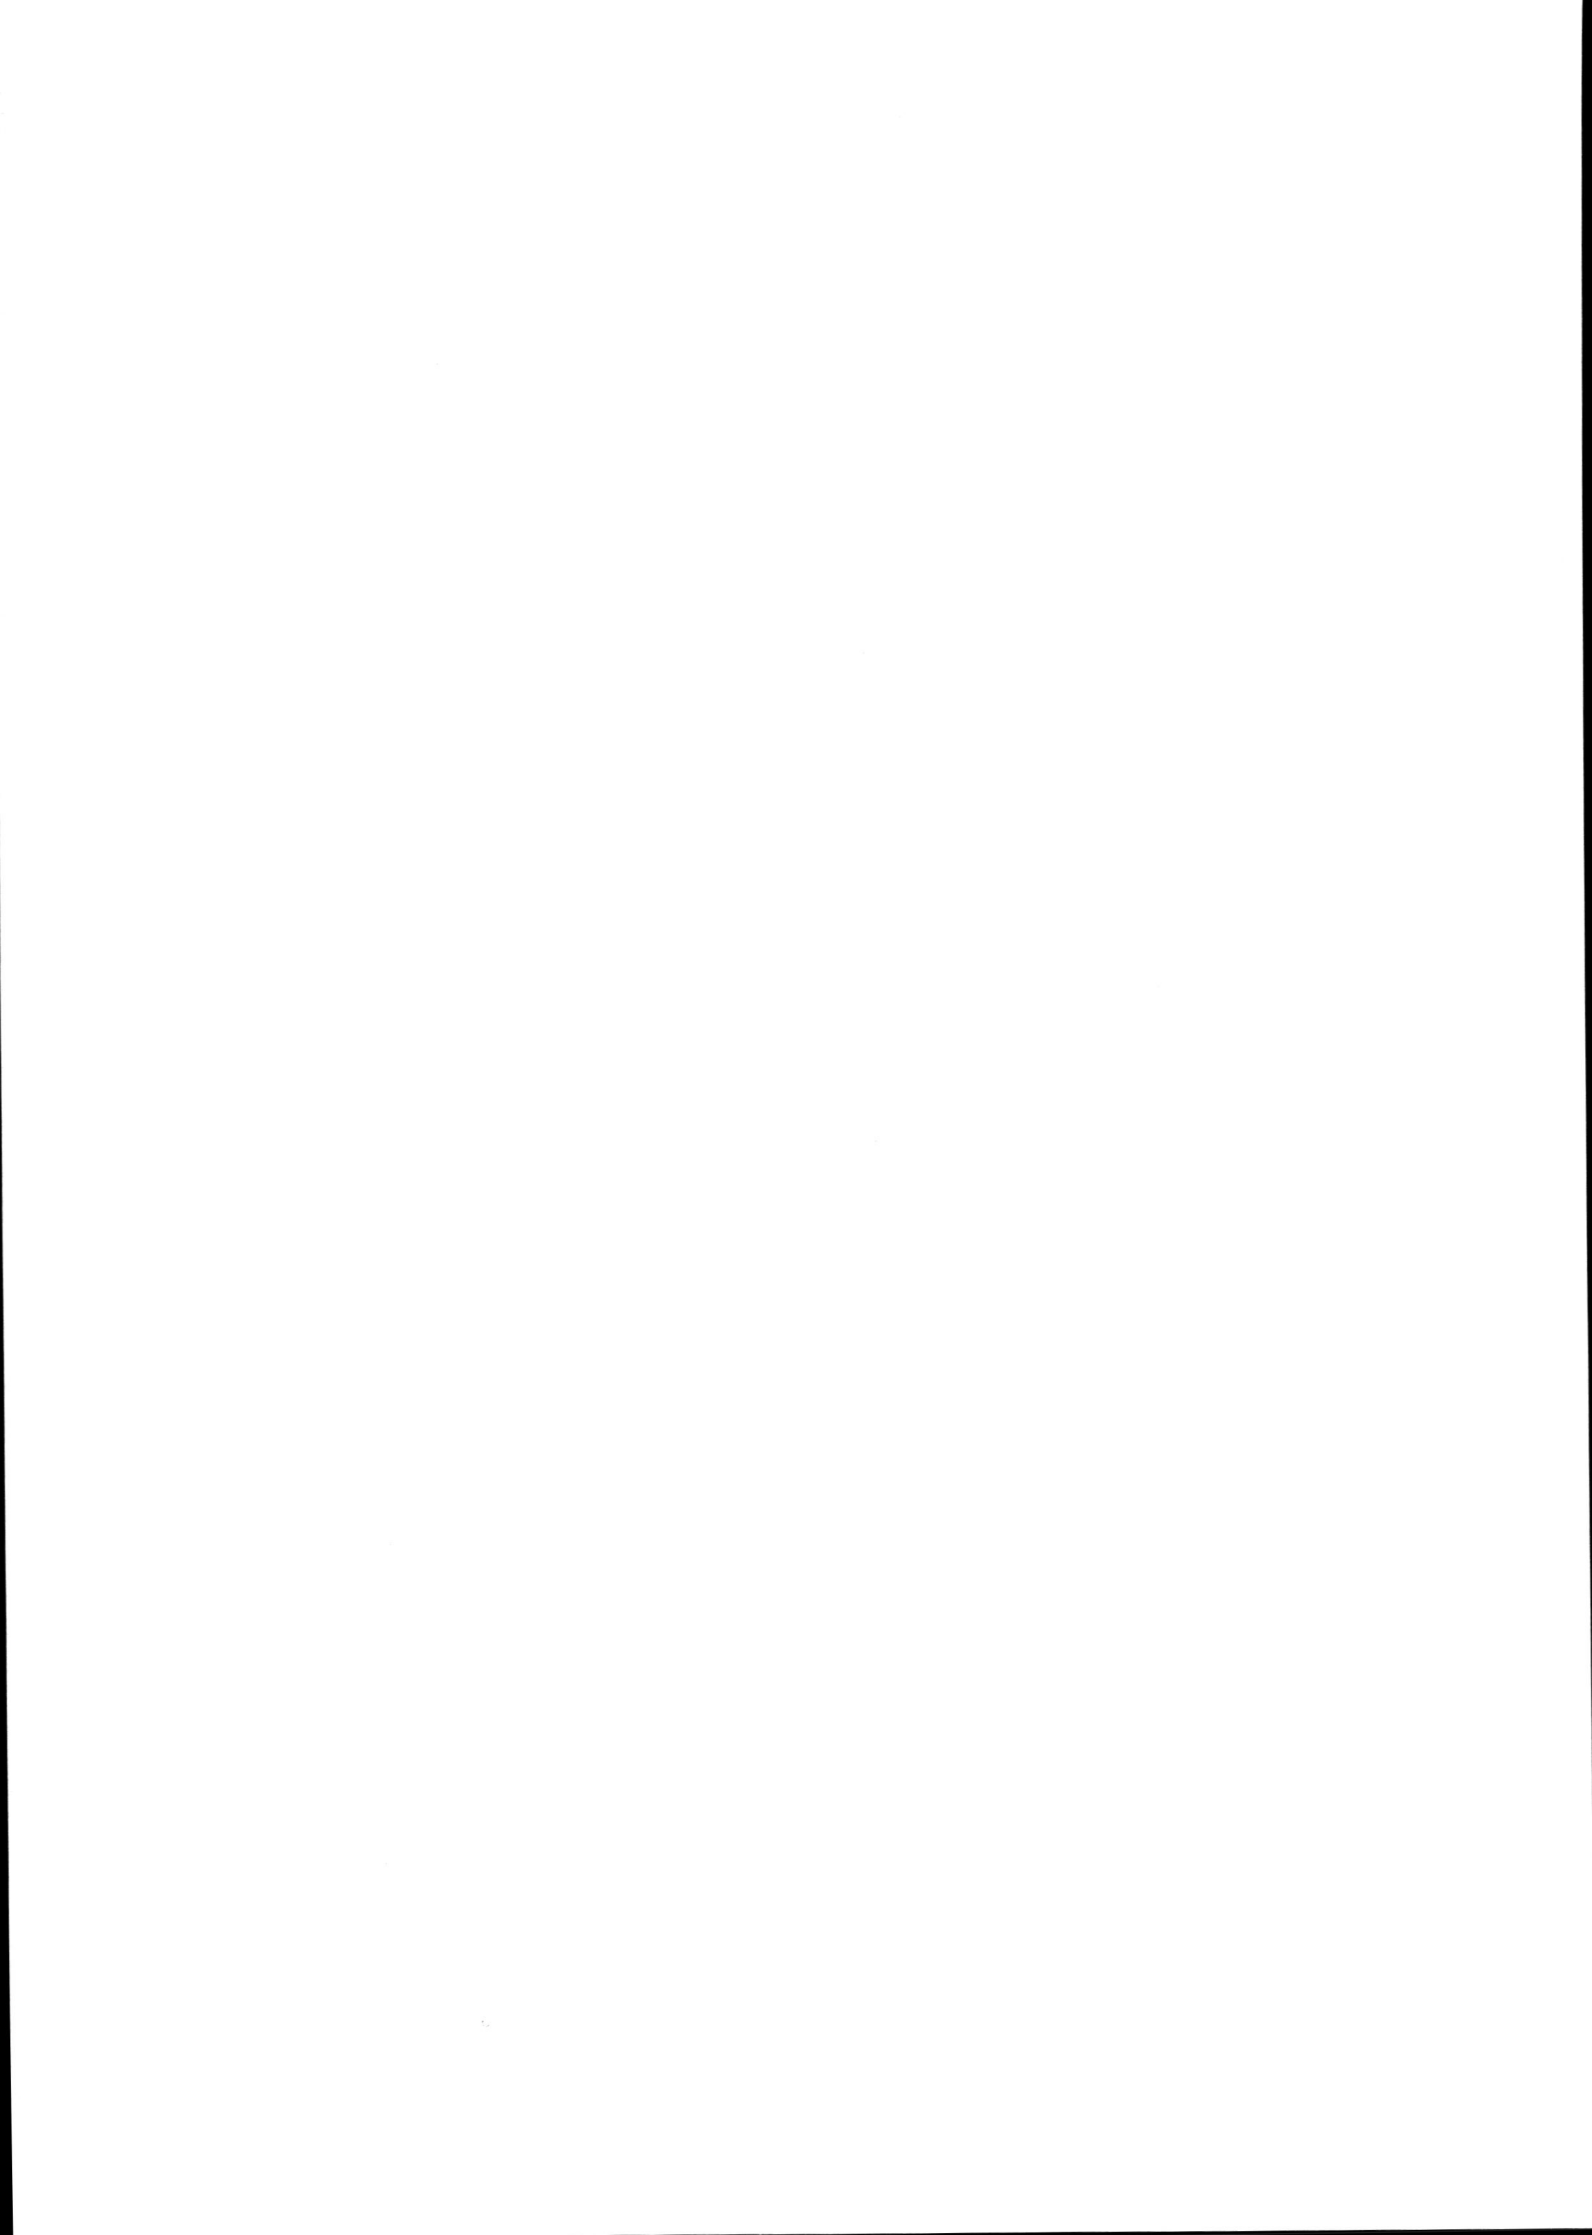

Pytanie 8:

W związku z zastrzeżeniem o możliwości nie złożenia zamówienia na część towaru prosimy o procentowe określenie minimalnych ilości, które zostaną przez Zamawiającego na pewno zamówione.

Odpowiedź:

Zamawiający określił to w paragrafie 9 wzoru umowy.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie pozycji 1,2,3,4 z Pakietu nr III i utworzenie z nich odrębnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający dzieli powyższy pakiet w następujący sposób: Pakiet III – pozycja 1,3,4 Pakiet IIIa – pozycja 2 Pakiet IIIb – pozycja 5 Pakiet IIIc – pozycja 6.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający dopuści w pozycjach 1, 2, 3 pakietu III protezy naczyniowe o następujących parametrach: niski stopień przepuszczalności, trombogeniczne, powlekane biomateriałem, możliwość trzykrotnej resterylizacji potwierdzonej i Instrukcji Użycia, rozciągliwe, wykonane z PTFE?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 11: Pakiet II poz. 1 i 4

Zwracamy się z prośbą o sprawdzenie czy nie zaszła pomyłka w opisie przedmiotu zamówienia i w pozycji 1 Zamawiający wymaga klipsów pakowanych po 6 i 10 sztuk oraz w pozycji 4 Zamawiający wymaga klipsów pakowanych po 4 i 6 sztuk?

Odpowiedź:

Istotnie nastąpiła omyłka, powinno być: pozycja 1 opakowania po 6 i 10 sztuk, oraz pozycja 4 opakowania po 4 i 6 sztuk.

Pytanie 12:

Prosimy o wydzielenie protez naczyniowych (pozycje: 1, 3 i 4) do osobnego pakietu, ponieważ stanowią one odrębną grupę asortymentową niż nici chirurgiczne, oznaczniki i lejce naczyniowe. Umożliwi to zwiększenie konkurencyjności.

Odpowiedź:

Zamawiający dzieli powyższy pakiet w następujący sposób: Pakiet III – pozycja 1,3,4 Pakiet IIIa – pozycja 2 Pakiet IIIb – pozycja 5 Pakiet IIIc – pozycja 6.

Pytanie 13:

Prosimy o określenie jakich średnic i długości protez z PTFE oczekuje Zamawiający w pozycji 1.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje protez o średnicy 4/6 mm.

Pytanie 14:

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 3 protez dzianych o długości 45cm w tej samej cenie.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian.

Pytanie 15:

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 4 protez dzianych w zakresie długości 25 - 40cm lub 30 – 50cm.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian.

Pytanie 16:

Prosimy o dookreślenie, że opisane pod formularzem cenowym wymagane parametry: niski stopień przepuszczalności, trombogeniczność, powleczenie biomateriałem i dwustronne welurowanie – dotyczą protez dzianych, natomiast do parametrów protez wykonanych z PTFE należeć mają: możliwość wielokrotnej resterylizacji oraz rozciągliwość.


Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian.

Pytanie 17:**Prosimy o zmianę z:**

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar na podstawie zamówienia w ciągu (max. 2 dni) od złożenia zamówienia, a w przypadku zamówień na „CITO” w ciągu 24 godzin. (...)

na:

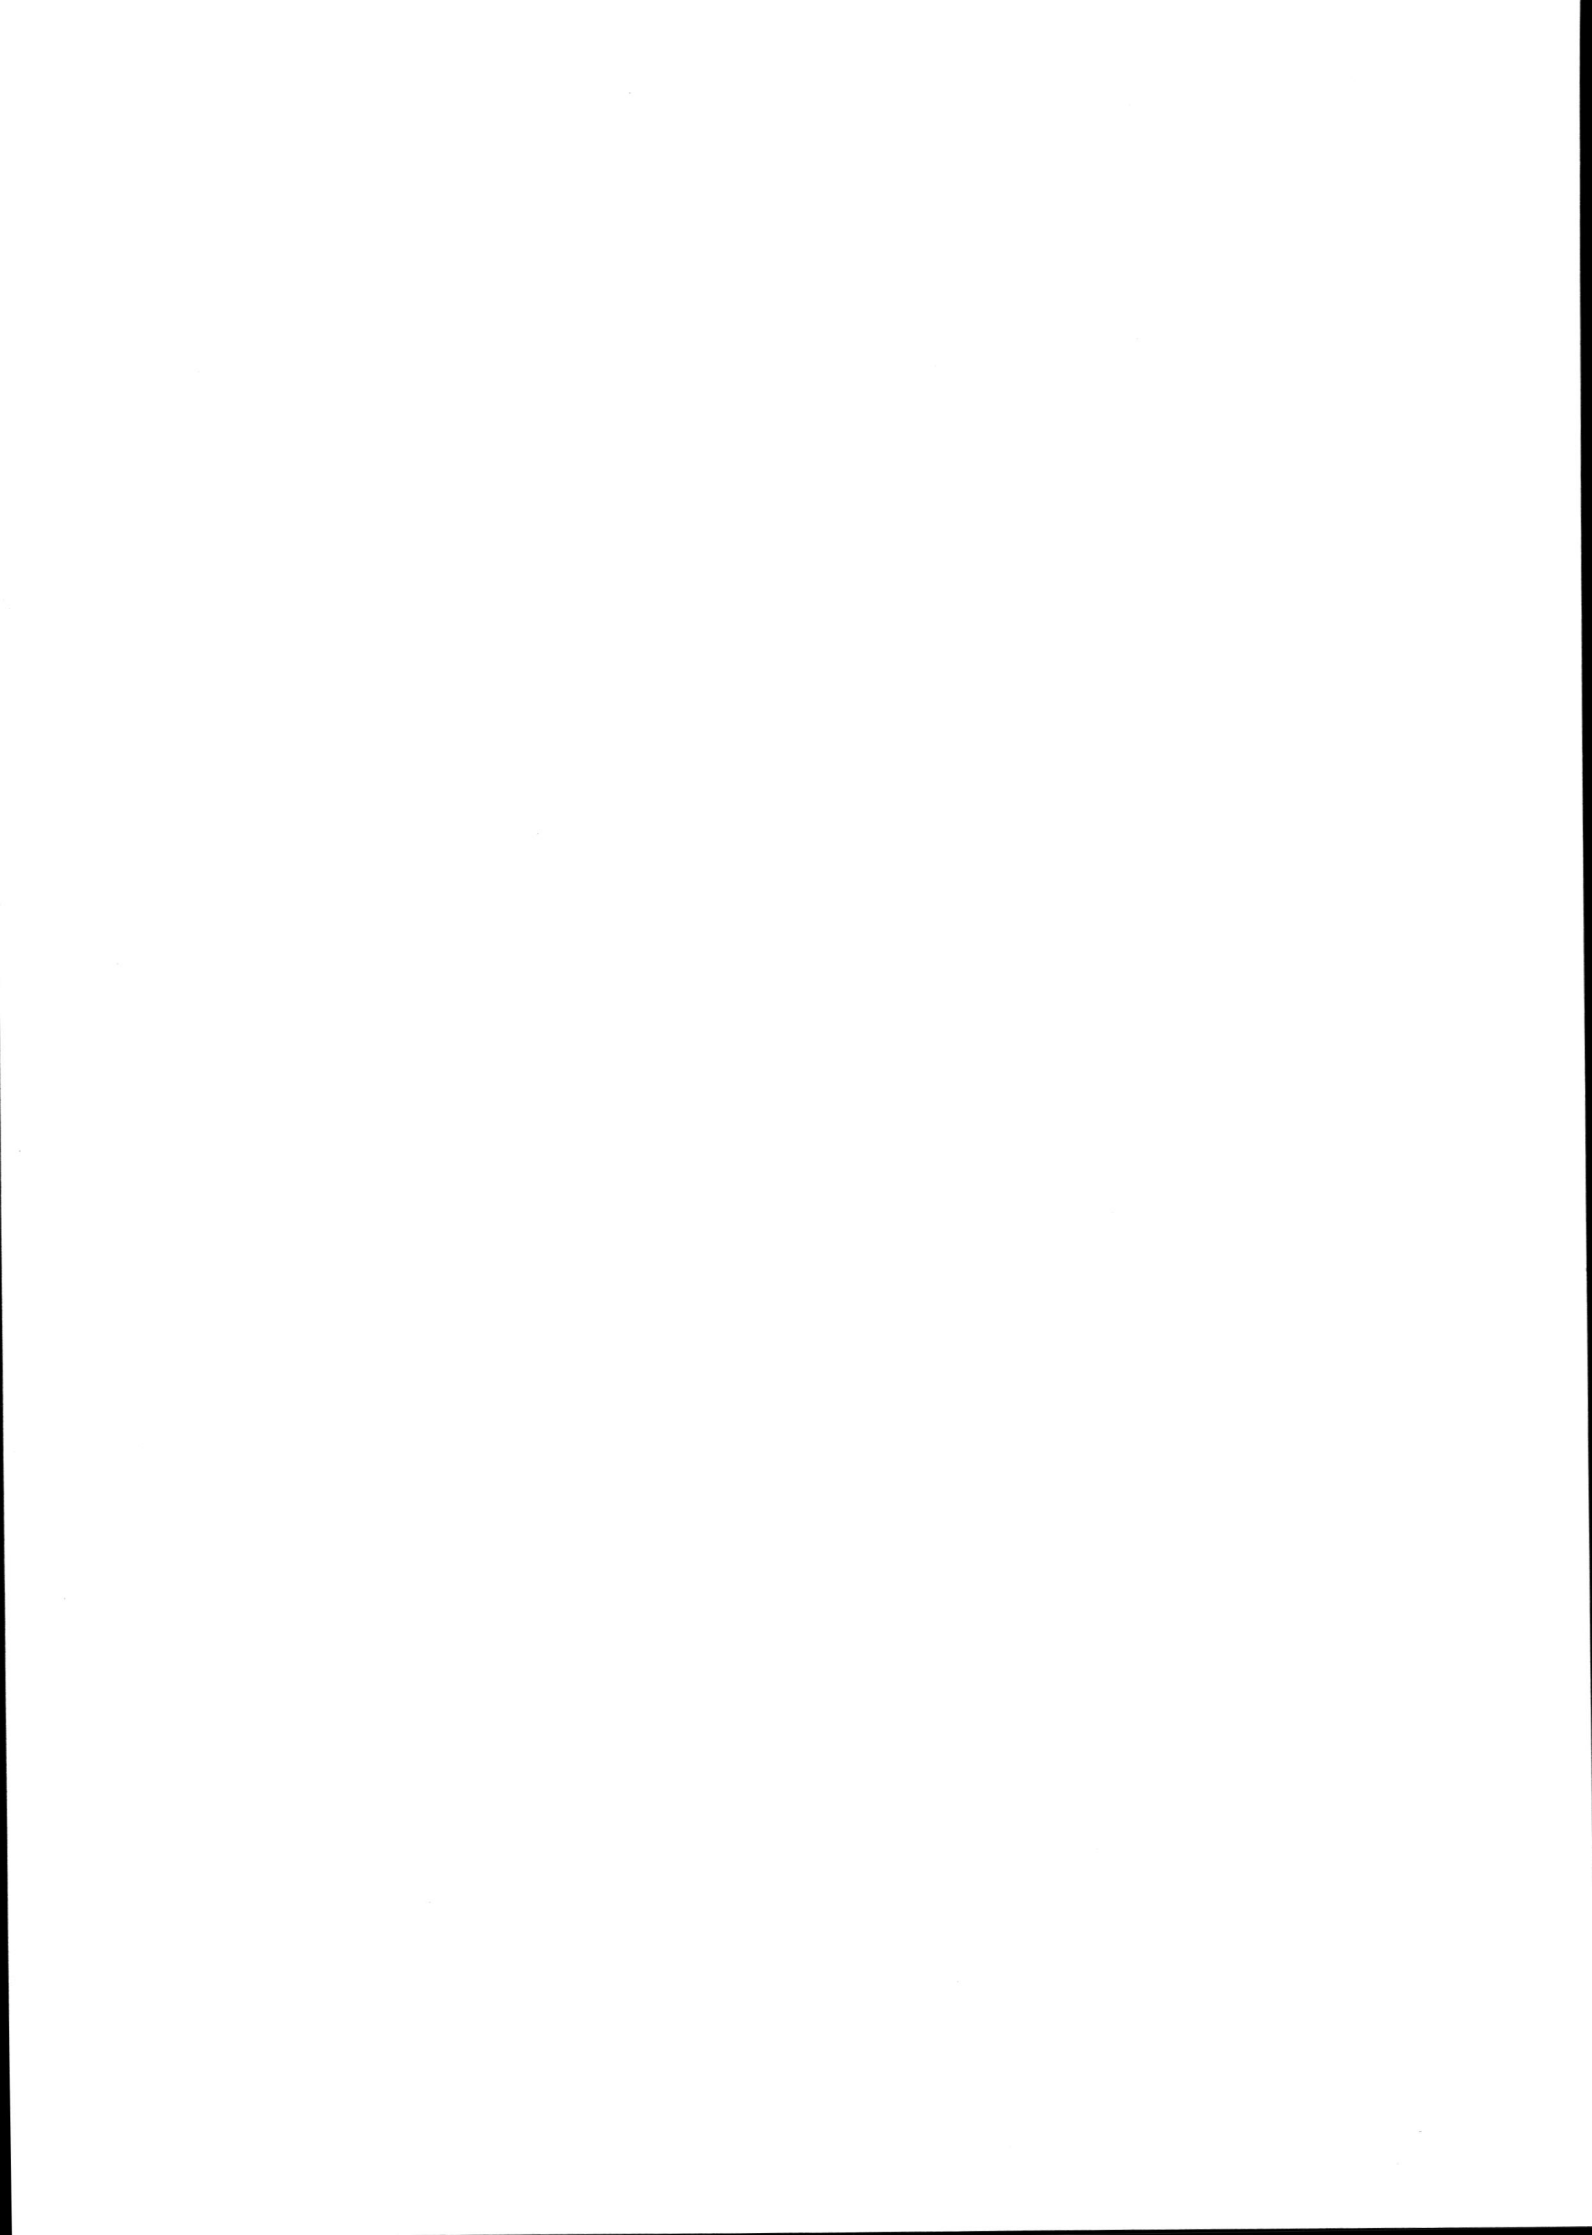

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar na podstawie zamówienia w ciągu (max. **2 dni robocze**) od złożenia zamówienia, a w przypadku zamówień na „CITO” w ciągu **24 godzin roboczych**. (...)

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 18:

Prosimy o zmianę z:

1. **Wykonawca** zobowiązany jest do zapłaty **Zamawiającemu** kar umownych w następujących wypadkach i w następujących wysokościach:

(1) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 2 % wartości niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia, (nie mniej niż 20 zł),

(2) w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji w wysokości 5 % wartości zareklamowanego towaru za każdy dzień opóźnienia (nie mniejszej niż 20 zł)

(3) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 20% wartości nie wykonanej części umowy (nie mniejszej niż 20 zł.),

(4) w przypadku opóźnienia, o którym mowa w pkt 1) lub nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji, o którym mowa w pkt. 2), przekraczającego 14 dni, **Zamawiający** zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczenia kar umownych w sposób określony w pkt 3).

na:

1. **Wykonawca** zobowiązany jest do zapłaty **Zamawiającemu** kar umownych w następujących wypadkach i w następujących wysokościach:

(1) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1 % wartości niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia,

(2) w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji w wysokości 2 % wartości zareklamowanego towaru za każdy dzień opóźnienia,

(3) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości nie wykonanej części umowy,

(4) w przypadku opóźnienia, o którym mowa w pkt 1) lub nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji, o którym mowa w pkt. 2), przekraczającego 14 dni, **Zamawiający** zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczenia kar umownych w sposób określony w pkt 3).

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 19:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą od Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 3 podpunktów nr 1, 3, 4 i utworzenie oddzielnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający dzieli powyższy pakiet w następujący sposób: Pakiet III – pozycja 1,3,4 Pakiet IIIa – pozycja 2 Pakiet IIIb – pozycja 5 Pakiet IIIc – pozycja 6.

Pytanie 20:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą od Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pakiecie nr 3 podpunkt 1 pod pojęciem „cieniowane” ma na myśli protezy stożkowe/zwężane i wyrazi zgodę na zaoferowanie protez o jednowarstwowej budowie ściany z zewnętrznym zbrojeniem możliwym do usunięcia bez naruszenia ściany naczyń o średnicy 4/7 mm i długości 45 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli protezy „cieniowane” (stożkowe/zwężane) o średnicy 4/6 mm.

Pytanie 21:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą od Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w przypadku protez rozwidlonych określonych w pakiecie nr 3 podpunkt 3 protez naczyńowych dzianych, uszczelnianych kolagenem, jednostronnie, zewnętrznie welurowanych, z dodatkowym odwróconym splotem, o grubości ściany 0,49 mm, przepuszczalności do 5 ml/cm²/min o oczekiwanych średnicach i długości 50 cm.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z zapisami siwz.

Pytanie 22:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą od Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w przypadku protez określonych w pakiecie nr 3 podpunkt nr 4 protez naczyńowych dzianych uszczelnianych kolagenem, jednostronnie, zewnętrznie welurowanych, z dodatkowym odwróconym splotem, o grubości ściany 0,49 mm, przepuszczalności do 5 ml/cm²/min o oczekiwanych średnicach i długościach.



Odpowiedź:

Nie, zgodnie z zapisami siwz.

Pytanie 23:

Pakiet 1I poz. 1 . Czy Zamawiający dopuści elektrodę w rozmiarze 20,0 x 11,2 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe wymiary, z zachowaniem pozostałych parametrów tj. kompatybilności z przewodami Valleylab i Erbe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy bezpłatnych próbek elektrod w celu oceny zgodności z wymogami siwz.

Pytanie 24:

Prosimy o dopuszczenie powrotnych elektrod jednorazowych do diatermii, dwudzielnych przystosowanych do systemu typu REM wyposażonych dodatkowo w system ścisłego przylegania brzeżnego zabezpieczającym przed zalaniem- pokrytych hydrożelem w kształcie prostokątnym o wymiarach 202x101mm (wymagane w SIWZ 180x115mm) z podłączenie kompatybilnym z przewodami firmy Valleylab i Erbe.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 25:

Prosimy o wydzielenie pozycji nr 2 tj.: „*bipolarny kabel łączący 4 m do pęsety bipolarnej. Kompatybilny z diatermią ERBE*” i utworzenie z niego odrębnego pakietu 1A. Wydzielenie tej pozycji z pakietu zwiększy grono oferentów co wpłynie na obniżenie ceny oferowanych elektrod. Pozostawienie oby pozycji w jednym pakiecie narzą kupującego na zakup elektrod po zawyżonych poprzez ograniczenie konkurencji cenach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 26:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie III b barwnych oznaczników do podtrzymywania naczyń krwionośnych wytworzonych z włókien poliestrowych techniką dziania w formie pasm o krawędziach bocznych zwiniętych do wewnątrz , posiadające trwałe wymiary podłużne i poprzeczne, przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrach ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 27:

Czy Zamawiający dopuści elektrody pokryte hydrożelem o grubości 0,7 mm +/- 15 mm oraz rozmiarze 20,2x10,1cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe wymiary, z zachowaniem pozostałych parametrów tj. kompatybilności z przewodami Valleylab i Erbe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy bezpłatnych próbek elektrod w celu oceny zgodności z wymogami siwz.

Pytanie 28:

Czy Zamawiający dopuści elektrody jednorazowe powrotne do diatermii dwudzielne przystosowane do systemu typu REM pokryte klejem przewodzącym, owalne o powierzchni 110 cm² kompatybilne z przewodami Valleylab i Erbe?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 29:

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały:

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar na podstawie zamówienia w ciągu (max. 3 dni) od złożenia zamówienia, a w przypadku zamówień na „CITO” w ciągu 48 godzin. (...)

Odpowiedź:


Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian.

Pytanie 30: Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały:

W razie braku zamówionego towaru lub zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo nabyć u innego podmiotu, taką samą ilość towaru, po uprzednim bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu do wykonania zobowiązania. W takim przypadku Wykonawca umowy zapłaci ewentualnie różnicę ceny nabycia na podstawie wystawionej przez Zamawiającego refaktury.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian.

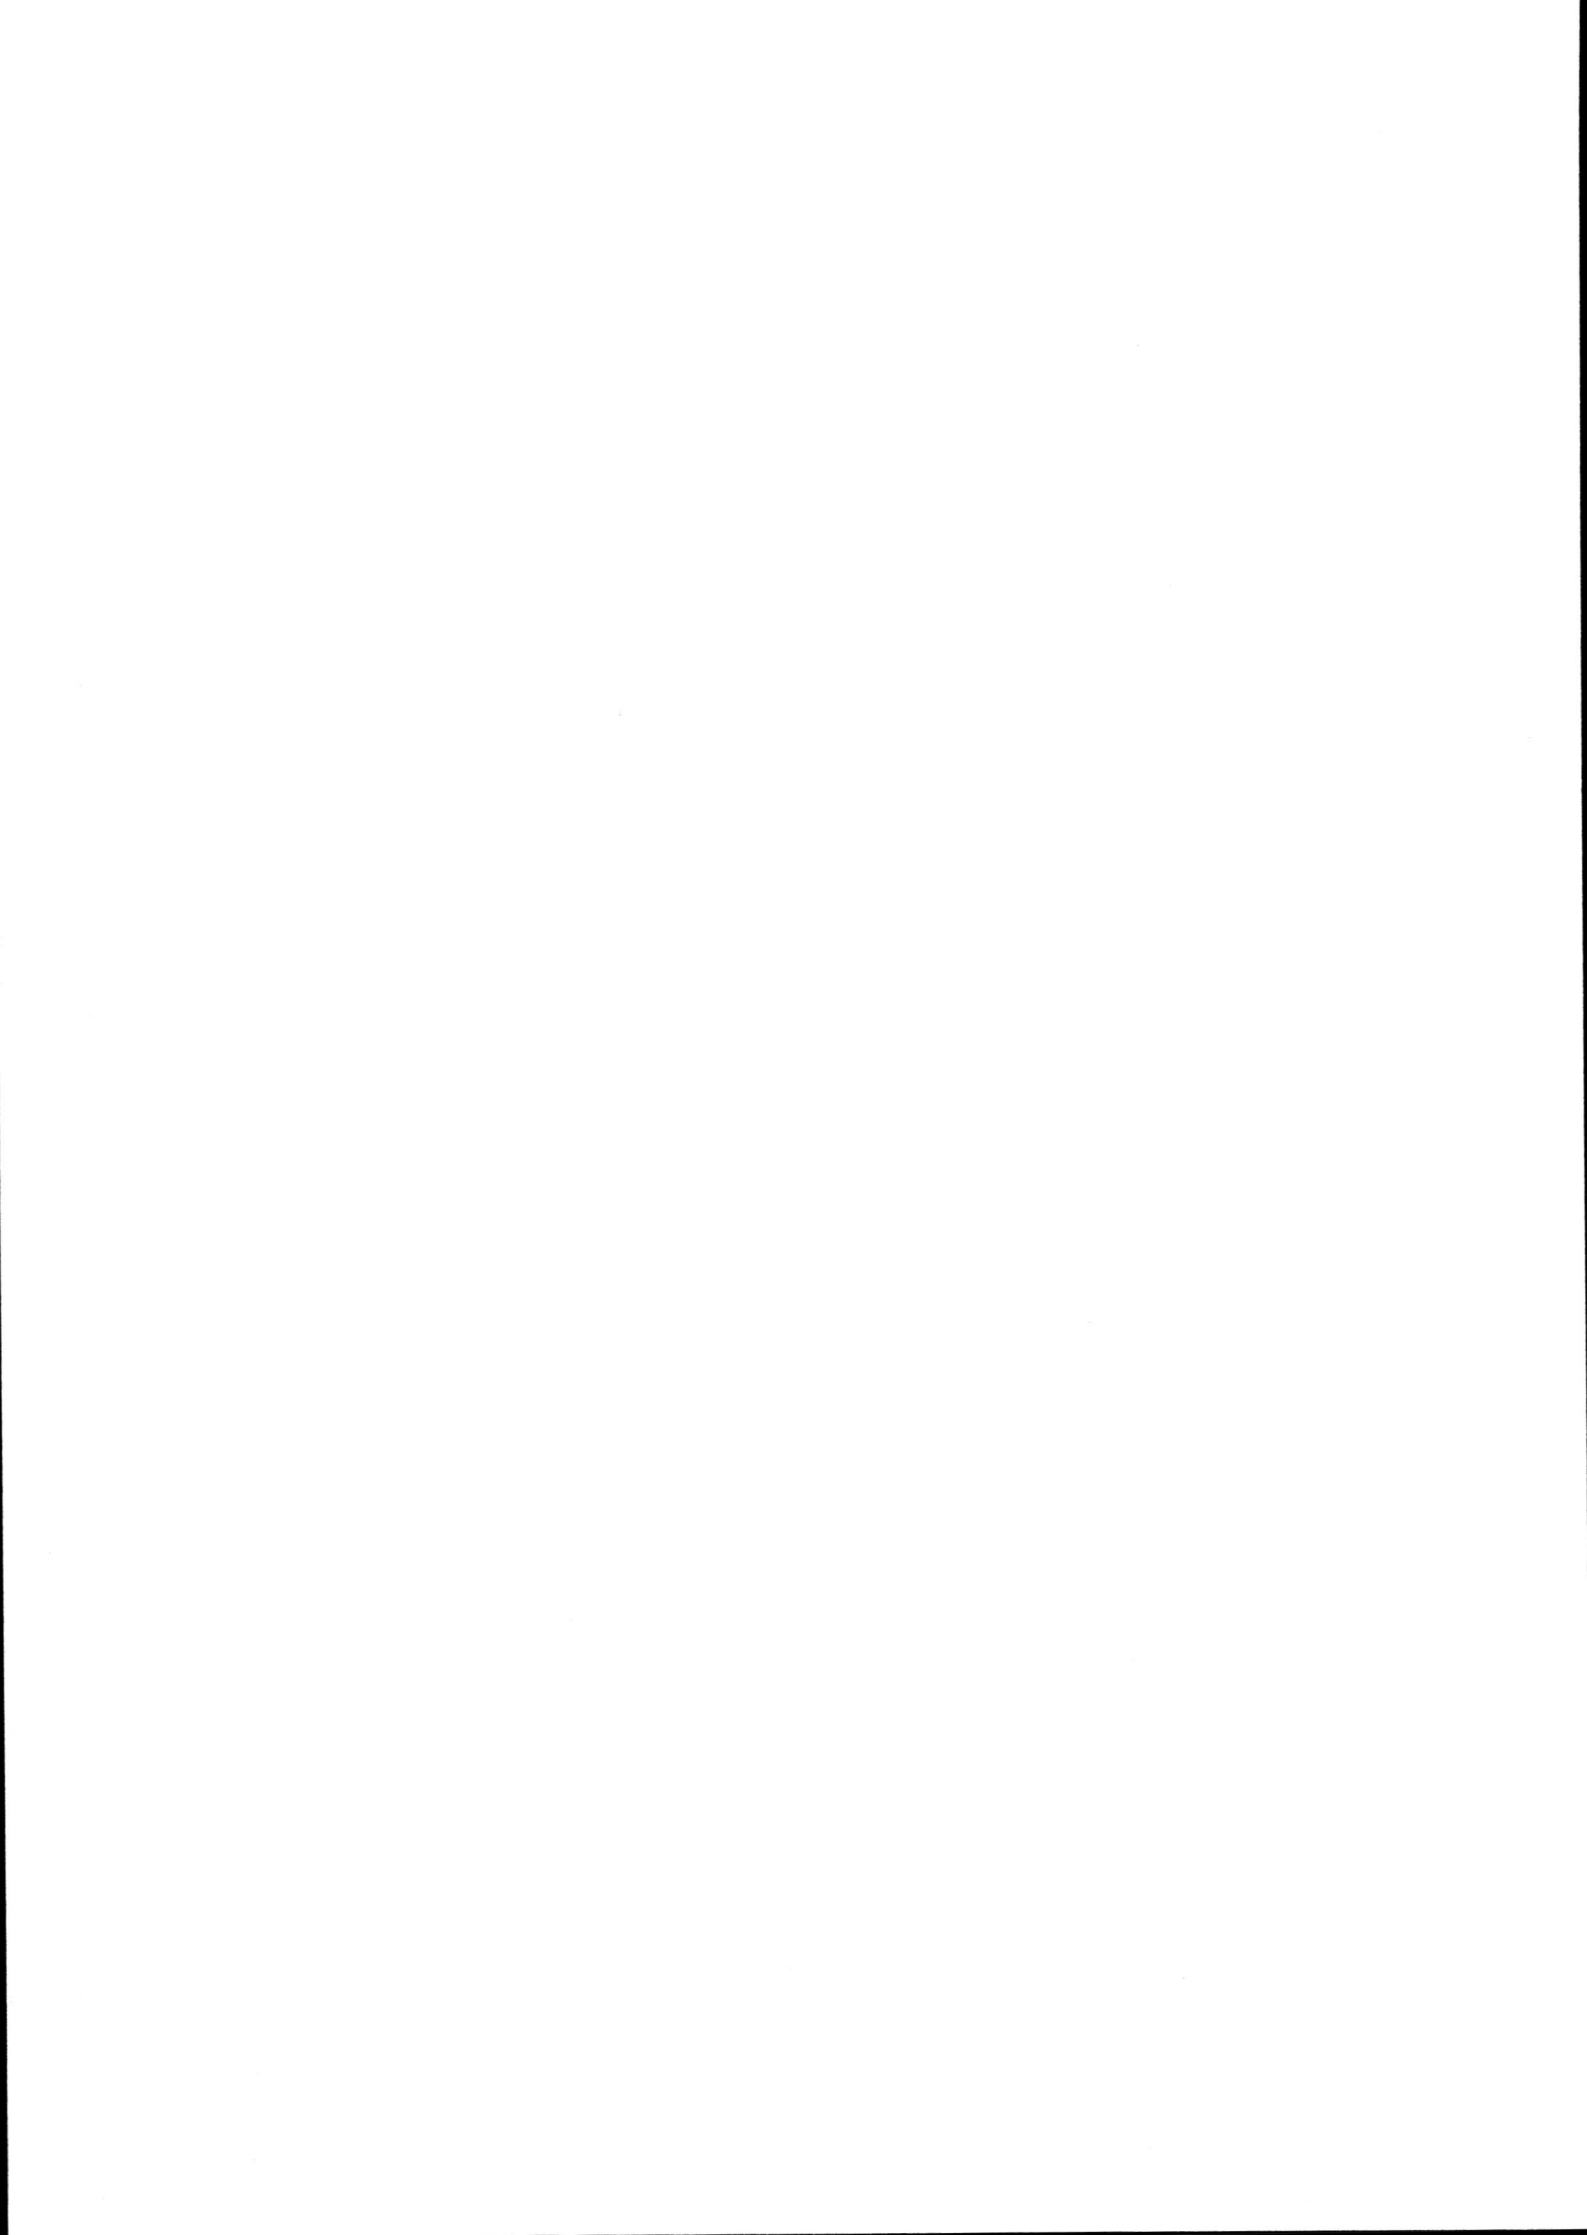

Pytanie 31: Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiały:

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty **Zamawiającemu** kar umownych w następujących wypadkach i w następujących wysokościach:

- 1) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia
- 1) w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji w wysokości 1% wartości zareklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki
- 2) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości nie wykonanej części umowy

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian.

Pytanie 32: Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiały:

W ramach niniejszej umowy zamówienie podstawowe stanowi 80% ilości towaru wskazanej w SIWZ (i załącznikach do SIWZ) postępowania. Tą wielkość zamówienia **Zamawiający** zrealizuje w każdym wypadku i za jej realizację w każdym wypadku zapłaci wynagrodzenie należne **Wykonawcy** w odpowiedniej części (z zastrzeżeniem § 8).

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian.

Pytanie 33: Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiały:

Pozostałe 20% ilości towaru wskazanej w SIWZ (i załącznikach do SIWZ) postępowania stanowi zamówienie opcjonalne (prawo opcji po stronie **Zamawiającego**). **Zamawiający** może z dowolnej części tej ilości lub z całości tej ilości skorzystać bądź nie – zależnie od bieżących potrzeb **Zamawiającego**.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian.

Pytanie 34: Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 3 ust. 10 zapisu:

„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”


Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż termin składania i otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 22.05.2012r., godziny pozostają bez zmian.

Z poważaniem


Z-ca DYREKTORA
d/s Lecznicy
Wojewódzkiego Szpitala Powiatowego
im. Jana Pawła II w Krośnie
lek. med. Małgorzata Jędrzak

